

Certificado de Calibração: 5888/24

Santos, 15/05/2024

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: Yara Brasil CUB5

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Plínio de Queirós, 1100, 11570-000 - Jardim Sao Marcos, Cubatão - SP

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Segurança

MODELO: SRVL-S4

CASTELO: Fechado

BALANCEADA: Não

PRESSÃO DE ABERTURA: 10,00 kgf/cm²

SELO UV: Não

IDENTIFICAÇÃO - TAG: PSV-01

FABRICANTE: SUPERLOK

NÚMERO DO LACRE: 0000211

CONEXÃO: 1/4"

FLUIDO TESTE: Água

VAZÃO: Nada consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (kgf/cm ²)	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3 (kgf/cm ²)	Média	Tendência	Incerteza	Tendênci a + U95
-	-	-	-	-	-	(U95)	-
10,00	10,00	9,90	10,00	9,97	-0,03	0,14613	0,17946

Pior tendência = 0,03 kgf/cm²

Pior incerteza (U95) = 0,14613 kgf/cm²; Veff = 2,09101; K = 4,33529

Pior |tendência+U95| = 0,17946 kgf/cm²

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2025	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: Conerge Santos/SP

UMIDADE: 67%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 25 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95.45 % de certeza.

Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais.

Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

000-Condição Normal


DATA CALIBRAÇÃO: 15/05/2024

LAUDO FINAL: APROVADO


PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 15/05/2025

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:

8.1 - TAG DO INSTRUMENTO

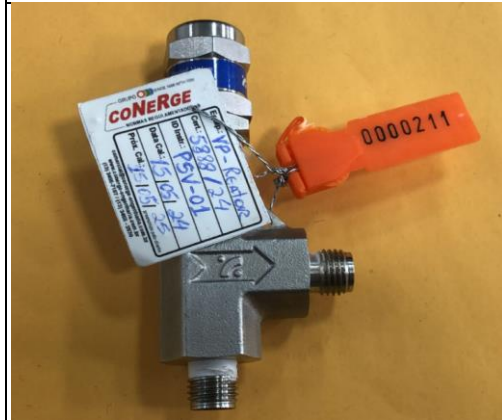

8.2 - DURANTE A CALIBRAÇÃO

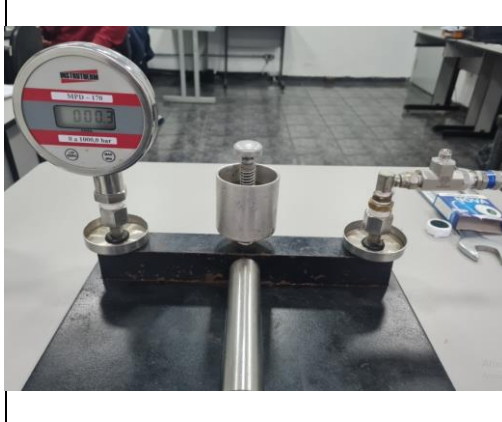

8.3 - FOTO DO INSTRUMENTO



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº KLEBER DOS SANTOS SAMPAIO
Responsável Técnico



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia